PHILIPS Service

AG 9018

Hi-Fi-Stereo-Verstärker

Spezial-Ersatzteile

Bei Bestellungen vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell-Nummer anzugeben!

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS Service Standardmaterial-Sortimenten enthalten.

Mechanische-Ersatzteile

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
1	Holzgehäuse	4822 1o3 oo214
2	Frontplatte	4822 o99 oo473
3	Gitter	4822 o99 oo474
4	Rückwand	4822 116 oo736
5	Fuß	P5 192 11
6	Knopf	A3 784 7o
7	Feder für Knopf	994/o4
8	Linse	A3 372 73
9	Buchse	A3 41o 65
1o	Schalter	A3 183 69
11	Spannungswähler	A3 187 45
12	Schalter (mono - stereo)	4822 117 oo246
13	Schalter (Plattenspieler, Tuner)	4822 117 oo247
14	Netzschalter	97o/o1UC
15	Buchsenplatte (Lautsprecher)	979/2x19
16	Drucktaste (stereo)	4822 116 oo737
17	Drucktaste (mono)	4822 116 oo738
18	Drucktaste (Tuner)	4822 116 oo739
19	Drucktaste (Plattenspieler)	4822 116 oo741
2o	Drucktaste (Tonbandgerät)	4822 116 oo742
21	Verlängerungsachse	916/o1
22	IEC-Buchse	979/F5x1
23	Buchse (Tonband)	979/F5x18o
24	Sicherung 1o A	o8 146 98
25	Sicherung 125 mA	974/V125
26	Sicherung 5oo mA	974/5oo
27	Netztrafo	A3 143 45
28	Signallampe	7999 D
29	Drosselspule	A3 16o o1
3o	Feder für IEC-Buchse	979/2o
31	Beschriftungsplatte (Vorderseite)	4822 1oo oo232

Elektrische-Ersatzteile

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
R1	Widerstand 47 Ω	938/B47E
R14/R114	Doppel-Potentiometer 2 x 1oo kΩ	E o91 CG/ooB14
R19/R119	Doppel-Potentiometer 2 x 1 MΩ	E o91 ZZ/45
R38	Widerstand 33o Ω	B8 3o5 o8B/33oE
R41	Widerstand 5oo Ω (regelbar)	E o97 AE/5ooE
R5o/R15o	Doppel-Potentiometer 2 x 1 MΩ	E o91 ZZ/45
R51/R151	Doppel-Potentiometer 2 x 1 MΩ	E o91 ZZ/45
R52/R152	Doppel-Potentiometer 2 x 1 MΩ	E o91 CG/ooB84
R138	Widerstand 33o Ω	B8 3o5 o8B/33oE
R141	Widerstand 5oo Ω (regelbar)	E o97 AE/5ooE
C1	HV-Elko 5o+5o µF, 45o V	913/P5o+5o
C2	HV-Elko 5o+5o µF, 45o V	913/P5o+5o
C3	HV-Elko 32+32 µF, 35o V	AC 5308/32+32
C6	NV-Elko 1oo µF, 6,4 V	909/A1oo
C7	HV-Elko 8+8µF, 45o V	911/P8+8
C16	NV-Elko 1oo µF, 6,4 V	909/A1oo
C26	NV-Elko 1oo µF, 4o V	909/X1oo
C27	HV-Elko 8+8 µF, 45o V	911/P8+8
C29	HV-Elko 5o+5o µF, 45o V	913/P5o+5o
C1o6	NV-Elko 1oo µF, 6,4 V	909/A1oo
C1o7	HV-Elko 8+8 µF, 45o V	911/P8+8
C116	NV-Elko 1oo µF, 6,4 V	909/A1oo
C126	NV-Elko 1oo µF, 4o V	909/X1oo
C127	HV-Elko 8+8 µF, 45o V	911/P8+8
C129	HV-Elko 5o+5o µF, 45o V	913/P5o+5o

Nachdruck nicht gestattet! Änderungen vorbehalten.

75 JAHRE FORTSCHRITT PHILIPS 1891 - 1966

PHILIPS Service

DEUTSCHE PHILIPS G.M.B.H. HAMBURG 1
SERVICE-ABT.

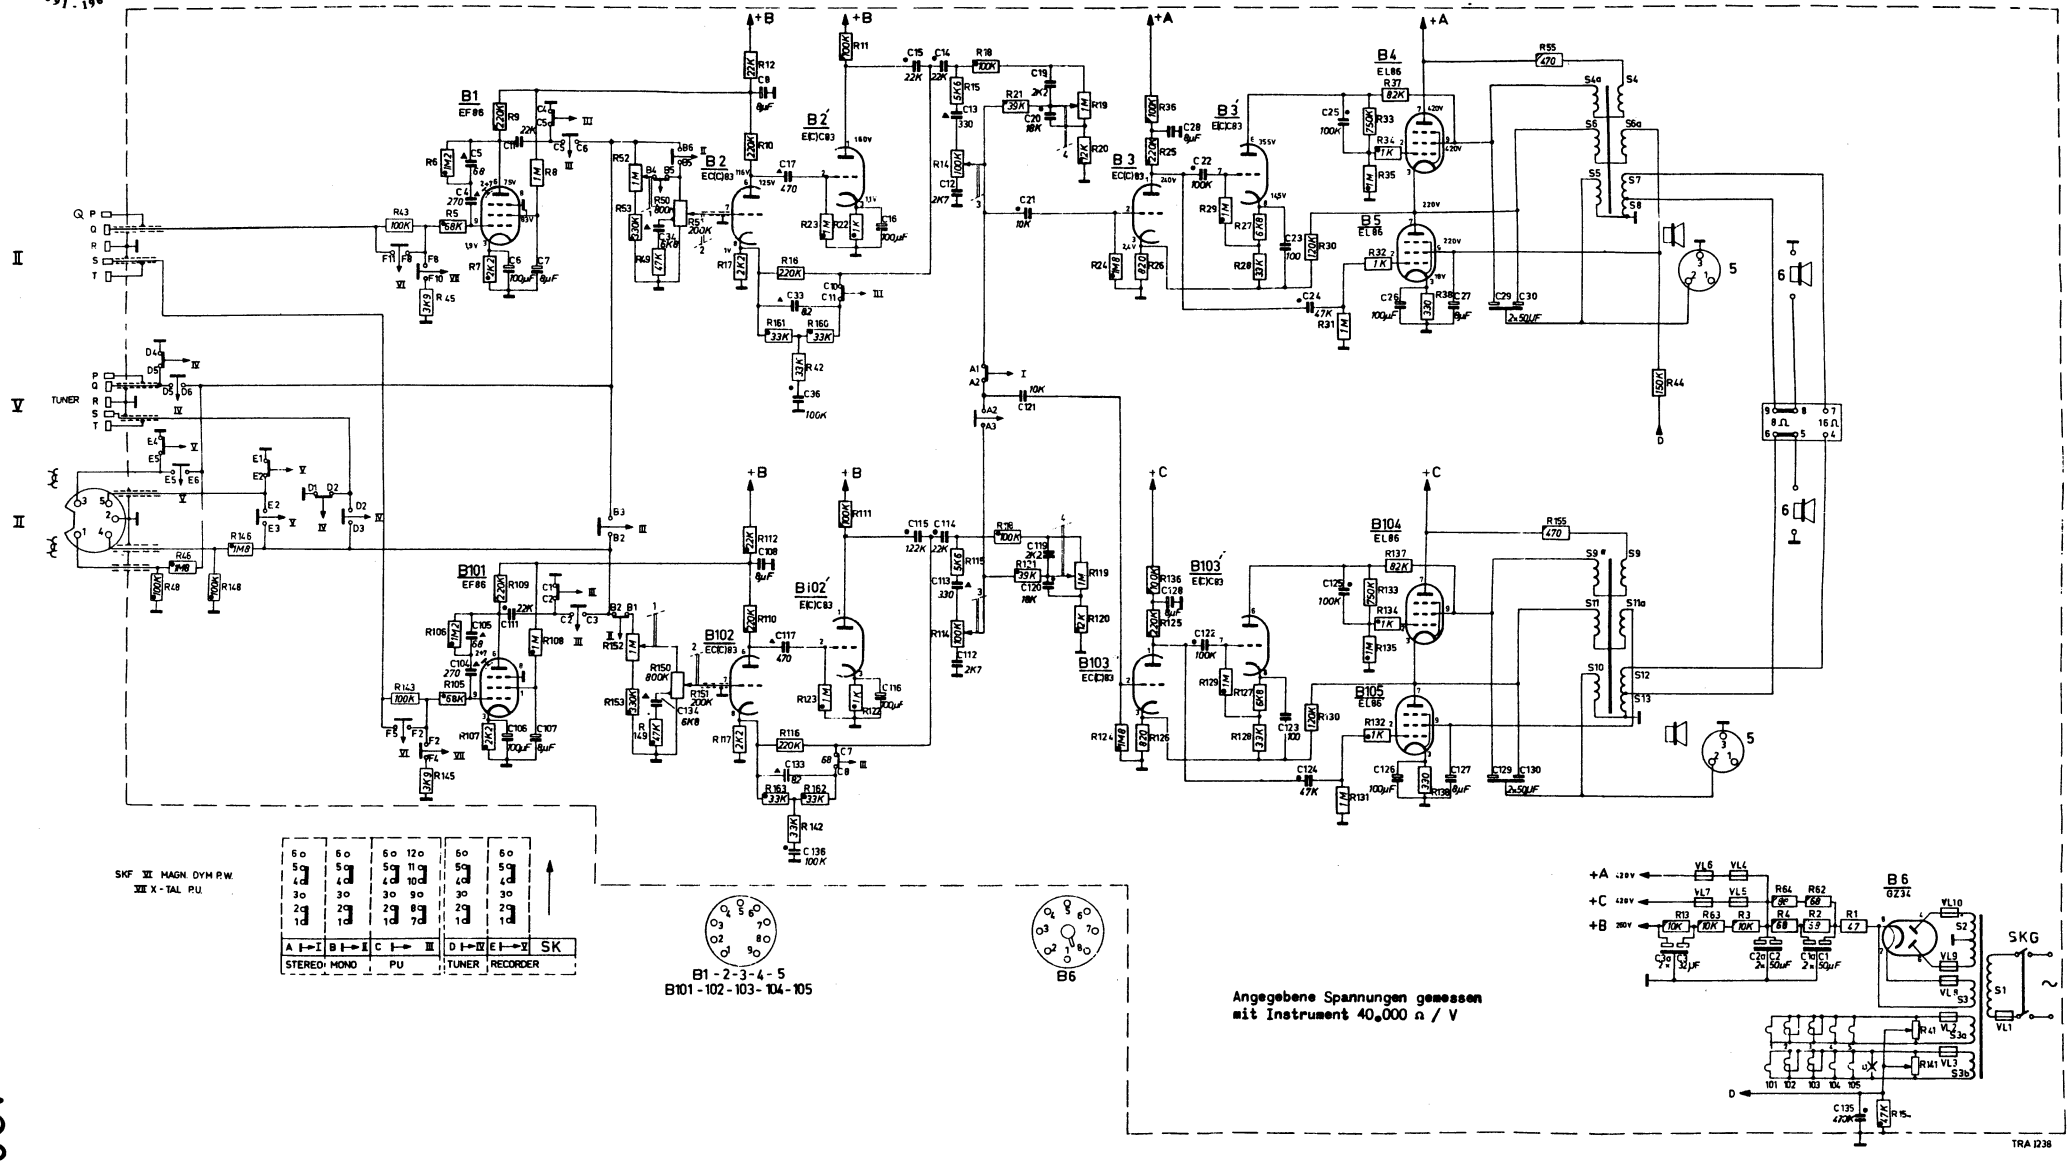

Nachdruck nicht gestattet! Änderungen vorbehalten.

75 JAHRE FORTSCHRITT PHILIPS 1891 - 1966

PHILIPS Service

AG 9018

Hi-Fi-Stereo-Verstärker

Spezial-Ersatzteile

Bei Bestellungen vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell-Nummer anzugeben!

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS Service Standardmaterial-Sortimenten enthalten.

Mechanische-Ersatzteile

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
1	Holzgehäuse	4822 1o3 oo214
2	Frontplatte	4822 o99 oo473
3	Gitter	4822 o99 oo474
4	Rückwand	4822 116 oo736
5	Fuß	P5 192 11
6	Knopf	A3 784 7o
7	Feder für Knopf	994/o4
8	Linse	A3 372 73
9	Buchse	A3 41o 65
1o	Schalter	A3 183 69
11	Spannungswähler	A3 187 45
12	Schalter (mono - stereo)	4822 117 oo246
13	Schalter (Plattenspieler, Tuner)	4822 117 oo247
14	Netzschalter	97o/o1UC
15	Buchsenplatte (Lautsprecher)	979/2x19
16	Drucktaste (stereo)	4822 116 oo737
17	Drucktaste (mono)	4822 116 oo738
18	Drucktaste (Tuner)	4822 116 oo739
19	Drucktaste (Plattenspieler)	4822 116 oo741
2o	Drucktaste (Tonbandgerät)	4822 116 oo742
21	Verlängerungsachse	916/o1
22	IEC-Buchse	979/F5x1
23	Buchse (Tonband)	979/F5x18o
24	Sicherung 1o A	o8 146 98
25	Sicherung 125 mA	974/V125
26	Sicherung 5oo mA	974/5oo
27	Netztrafo	A3 143 45
28	Signallampe	7999 D
29	Drosselspule	A3 16o o1
3o	Feder für IEC-Buchse	979/2o
31	Beschriftungsplatte (Vorderseite)	4822 1oo oo232

Elektrische-Ersatzteile

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
R1	Widerstand 47 Ω	938/B47E
R14/R114	Doppel-Potentiometer 2 x 1oo kΩ	E o91 CG/ooB14
R19/R119	Doppel-Potentiometer 2 x 1 MΩ	E o91 ZZ/45
R38	Widerstand 33o Ω	B8 3o5 o8B/33oE
R41	Widerstand 5oo Ω (regelbar)	E o97 AE/5ooE
R5o/R15o	Doppel-Potentiometer 2 x 1 MΩ	E o91 ZZ/45
R51/R151	Doppel-Potentiometer 2 x 1 MΩ	E o91 ZZ/45
R52/R152	Doppel-Potentiometer 2 x 1 MΩ	E o91 CG/ooB84
R138	Widerstand 33o Ω	B8 3o5 o8B/33oE
R141	Widerstand 5oo Ω (regelbar)	E o97 AE/5ooE
C1	HV-Elko 5o+5o µF, 45o V	913/P5o+5o
C2	HV-Elko 5o+5o µF, 45o V	913/P5o+5o
C3	HV-Elko 32+32 µF, 35o V	AC 53o8/32+32
C6	NV-Elko 1oo µF, 6,4 V	9o9/A1oo
C7	HV-Elko 8+8µF, 45o V	911/P8+8
C16	NV-Elko 1oo µF, 6,4 V	9o9/A1oo
C26	NV-Elko 1oo µF, 4o V	9o9/X1oo
C27	HV-Elko 8+8 µF, 45o V	911/P8+8
C29	HV-Elko 5o+5o µF, 45o V	913/P5o+5o
C1o6	NV-Elko 1oo µF, 6,4 V	9o9/A1oo
C1o7	HV-Elko 8+8 µF, 45o V	911/P8+8
C116	NV-Elko 1oo µF, 6,4 V	9o9/A1oo
C126	NV-Elko 1oo µF, 4o V	9o9/X1oo
C127	HV-Elko 8+8 µF, 45o V	911/P8+8
C129	HV-Elko 5o+5o µF, 45o V	913/P5o+5o

Nachdruck nicht gestattet! Änderungen vorbehalten.

PHILIPS Service
15 JAHRE FORTSCHRITT 1891 - 1966

DEUTSCHE PHILIPS G.M.B.H. HAMBURG 1
SERVICE-ABT.

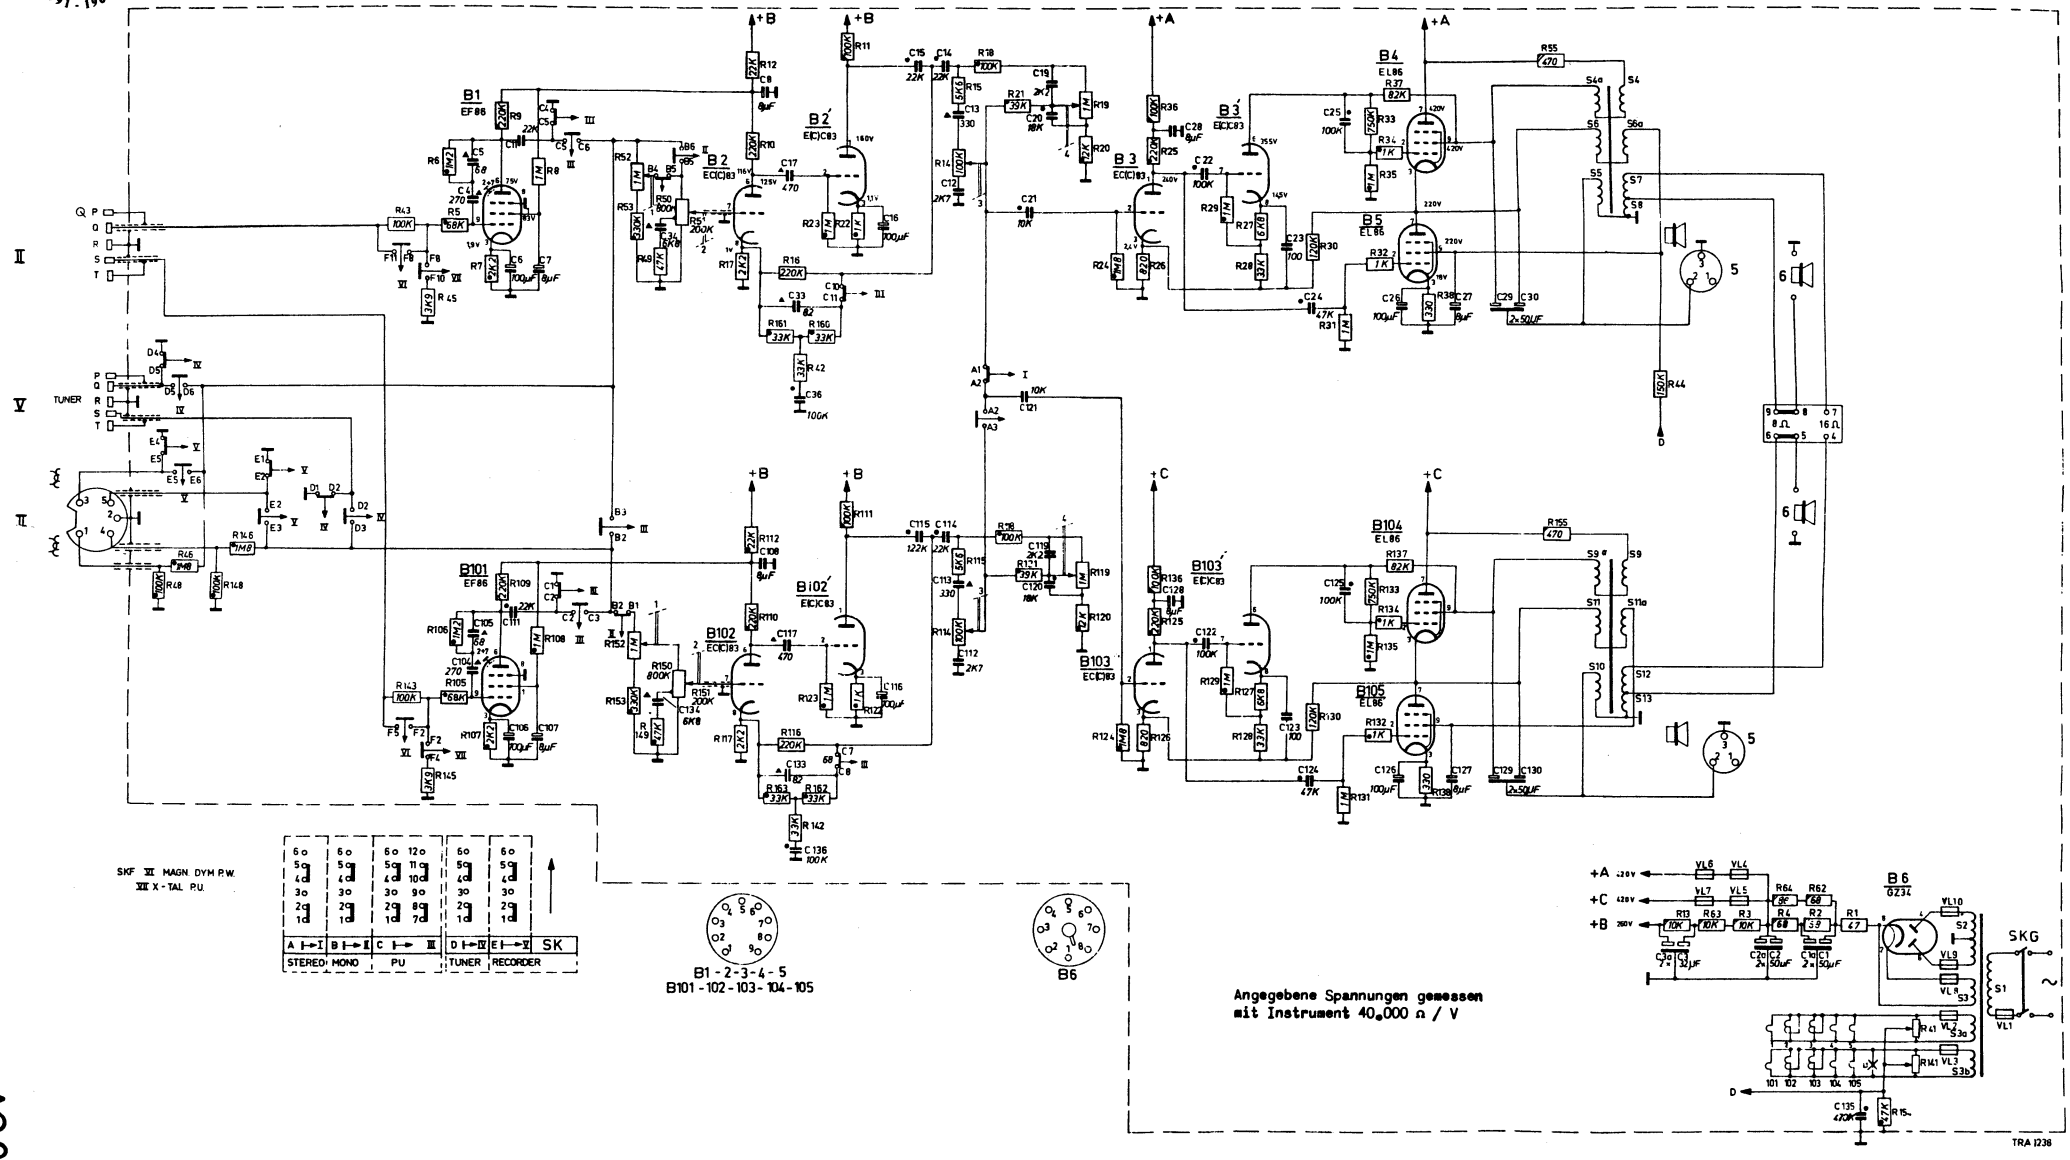

Nachdruck nicht gestattet! Änderungen vorbehalten.